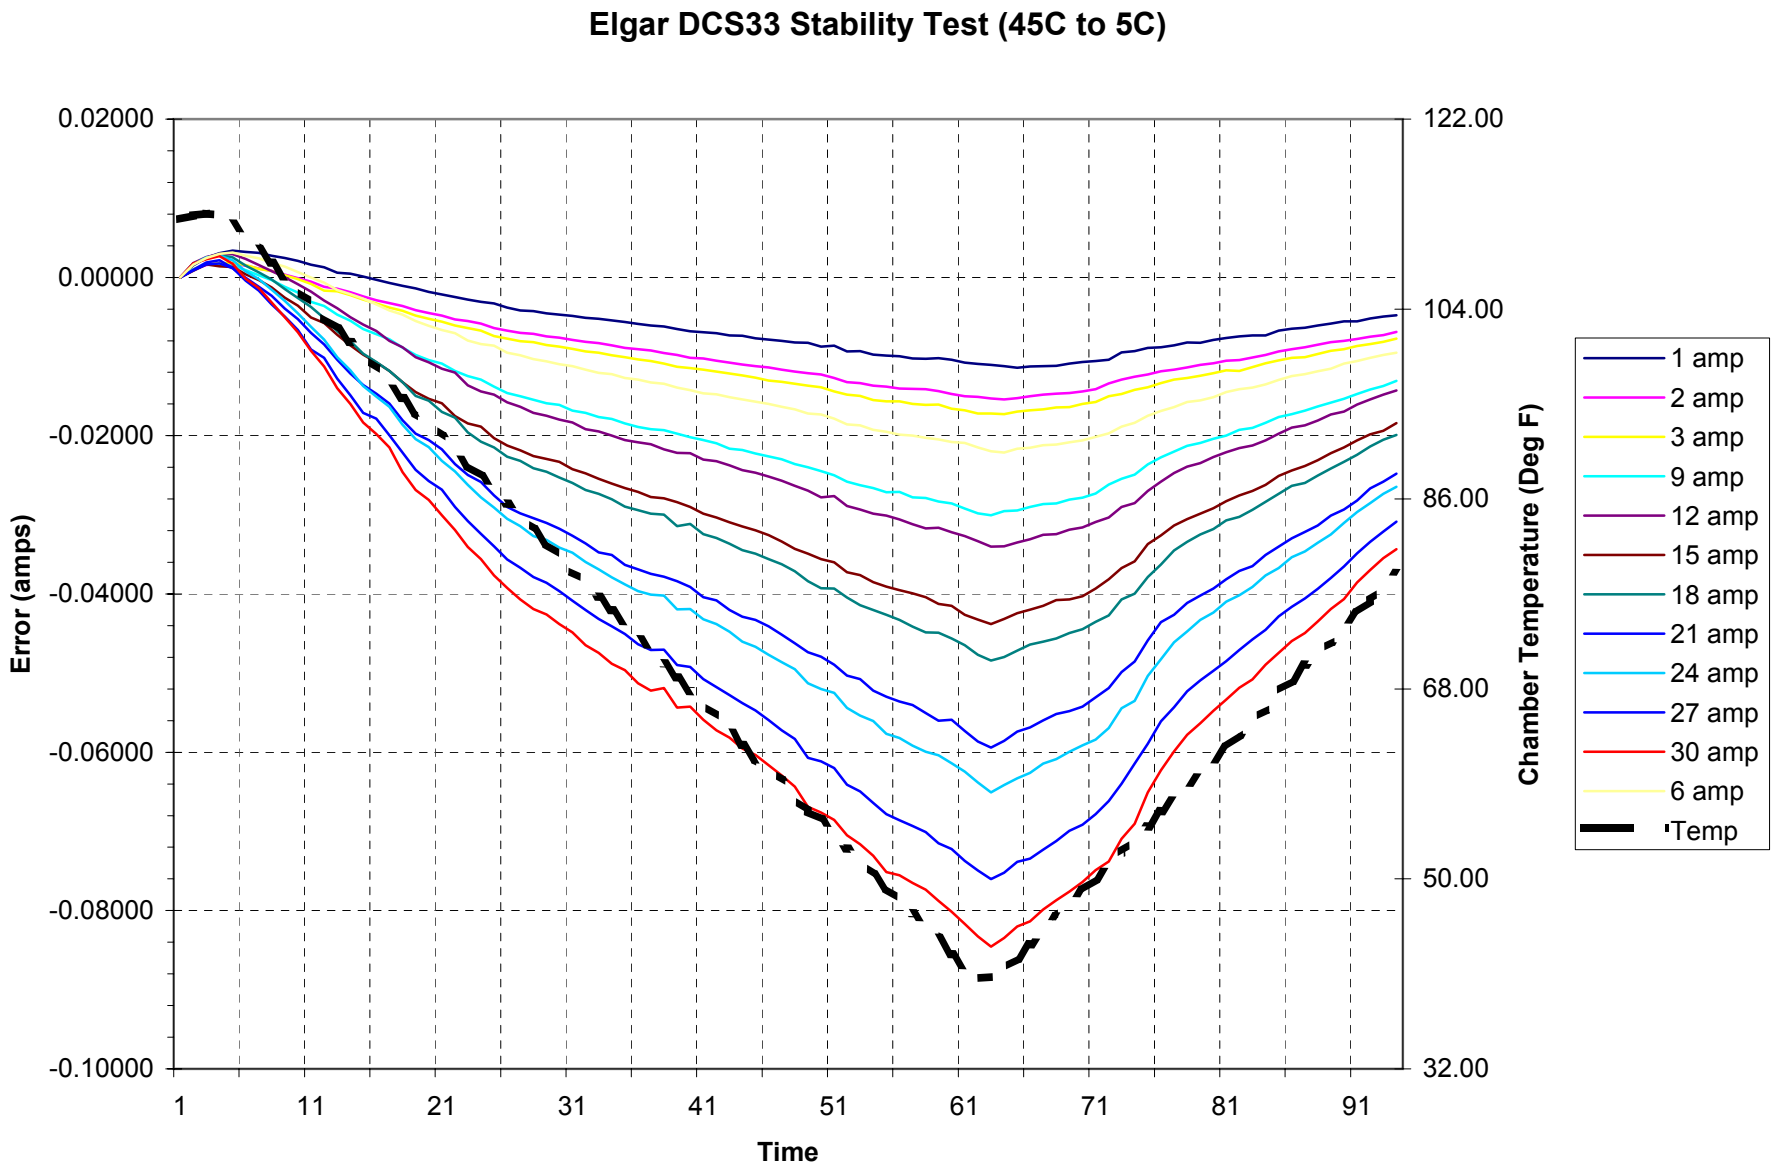
Elgar DCS33 Stability Test (45C to 5C)
0.02000
0.00000
-0.02000
-0.04000
-0.06000
-0.08000
-0.10000
Error (amps)
122.00
104.00
86.00
68.00
50.00
32.00
Chamber Temperature (Deg F)
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
Time
1 amp
2 amp
3 amp
9 amp
12 amp
15 amp
18 amp
21 amp
24 amp
27 amp
30 amp
6 amp
Temp